



NB. NELLA VERSIONE 1210/1
SONO MANCANTI I DUE STRUMENTI
CON I RELATIVI TRIMMER ED IL
POTENZIOMETRO DA 4,7 K Ω .
VIENE PERO' ESEGUITO IL
COLLEGAMENTO X.

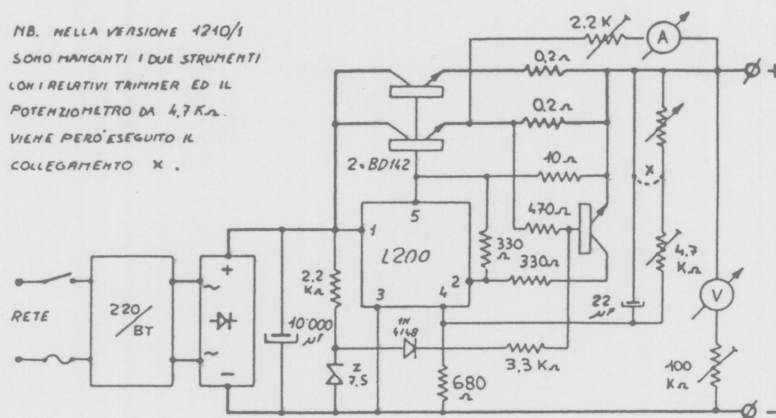


1210-1 1210-5

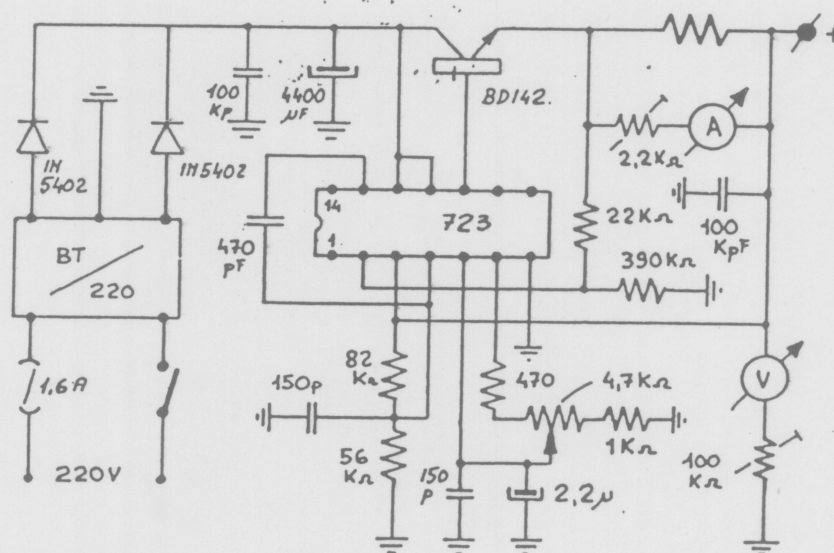



156S

1220-1
1220-5

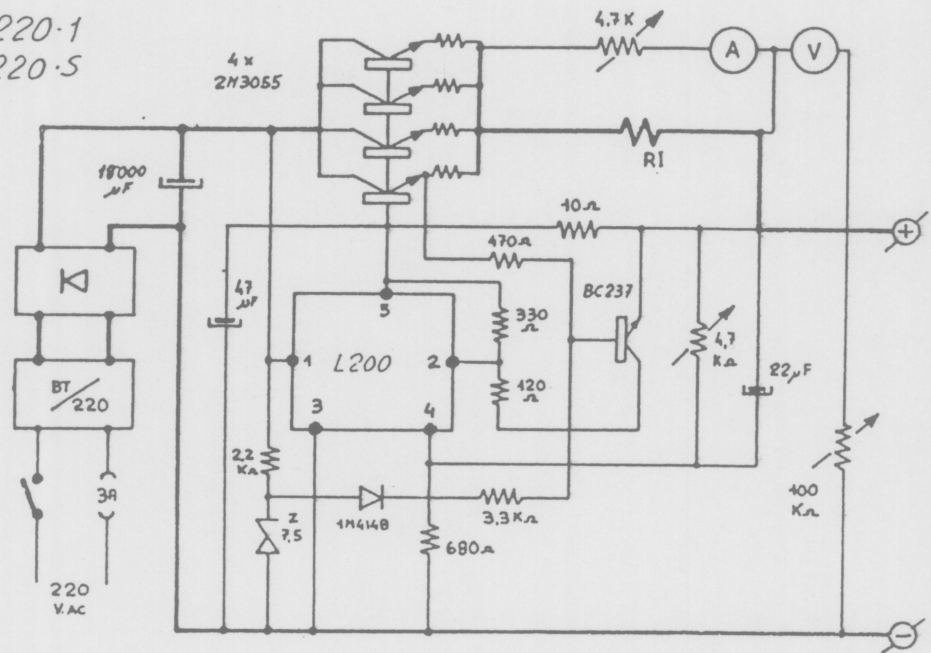


1240-5
1240-1
ZETAGI

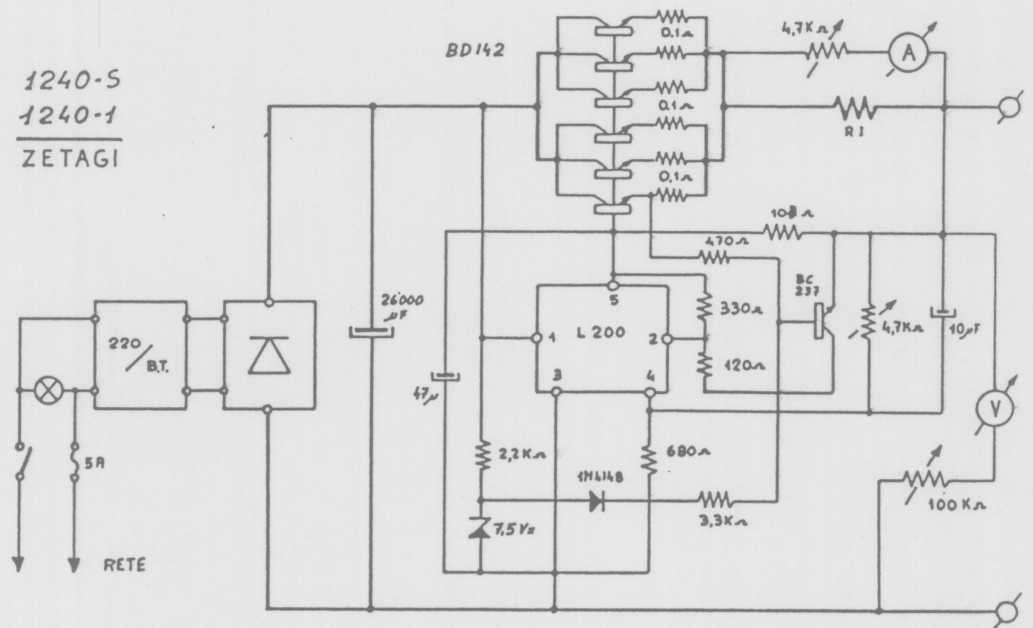

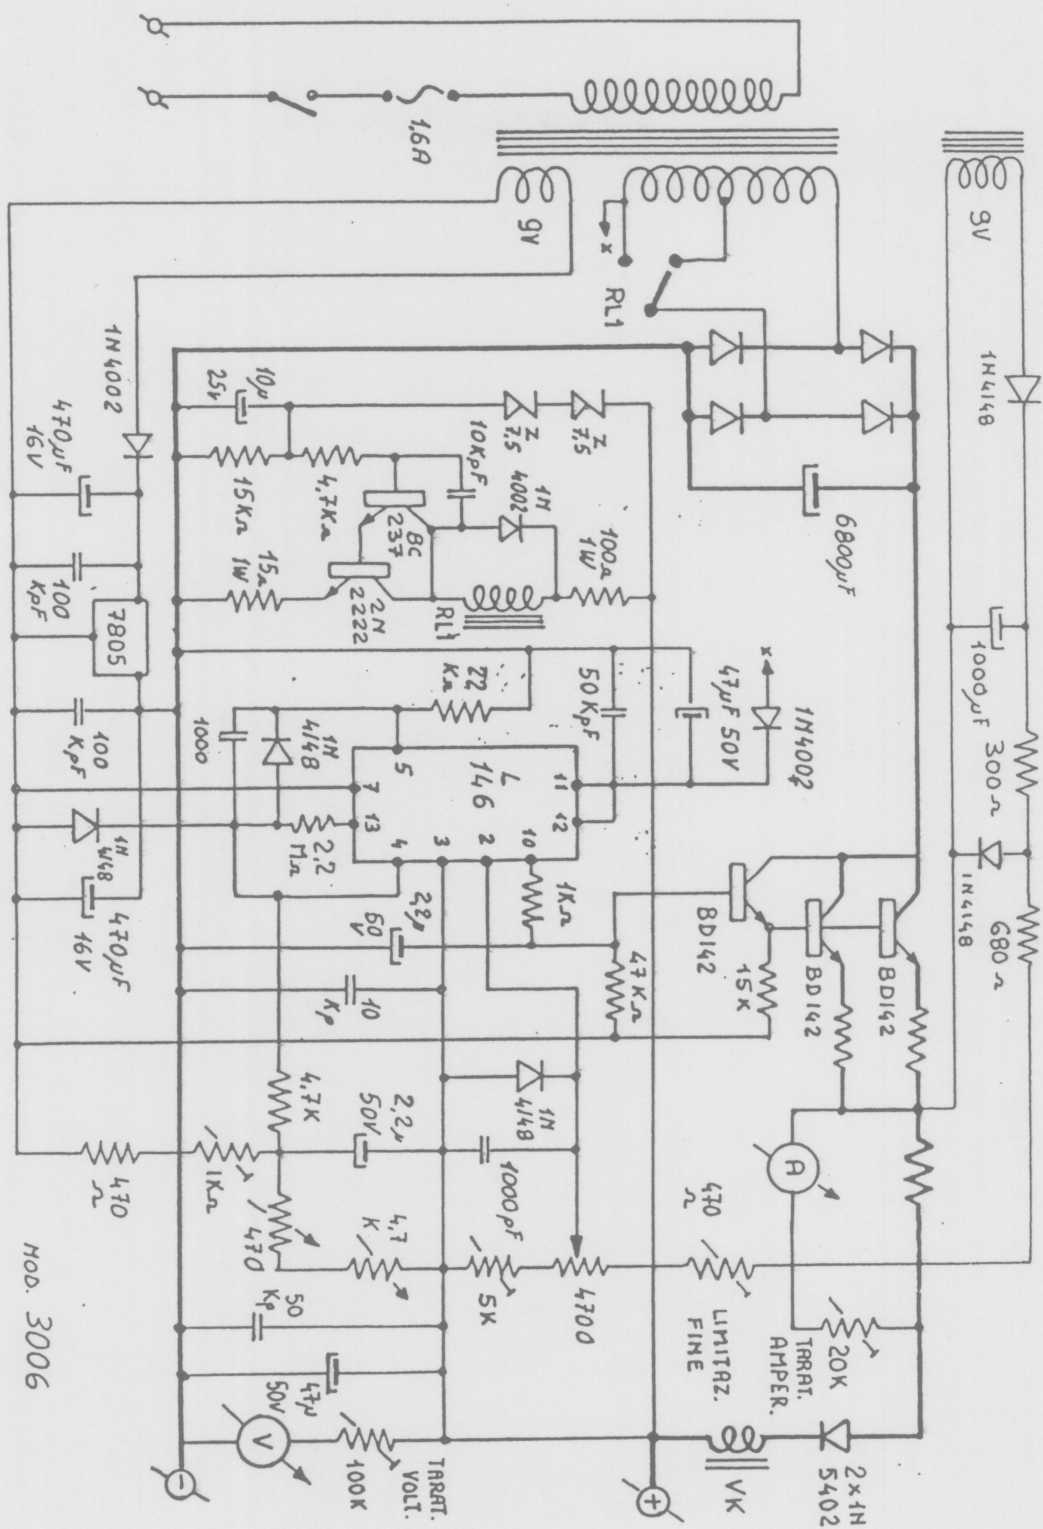

Mod. 3006



IND. 30 SERIES
8222A.